NAGASHIMA

耳鼻科用診療椅子 Bellety

操作スイッチのコードを無くし、使いやすさを追求

サイドスイッチ

操作スイッチを両サイドに
標準装備しています。

ハンドスイッチ（無線タイプ）

リモコンで離れた場所からの
操作が可能です。※オプション
単 4 乾電池 3 本使用

フットスイッチ

コードレス型フットスイッチを
標準装備、 足元がすっきりします。
単 3 乾電池 4 本使用

上記スイッチでは、 昇降・リクライニング・プリセット
オートリターン・回転ロックの操作が出来ます

COLOR

サックスブルー

カラーバリエーションについては
お問い合わせください。

電動キャスター

車椅子患者診察などスペースが必要なシーンで
すぐに移動が可能です。※オプション

電動油圧駆動方式を採用することで、
耐久性と動きのスムーズさを実現しています。

外形寸法図

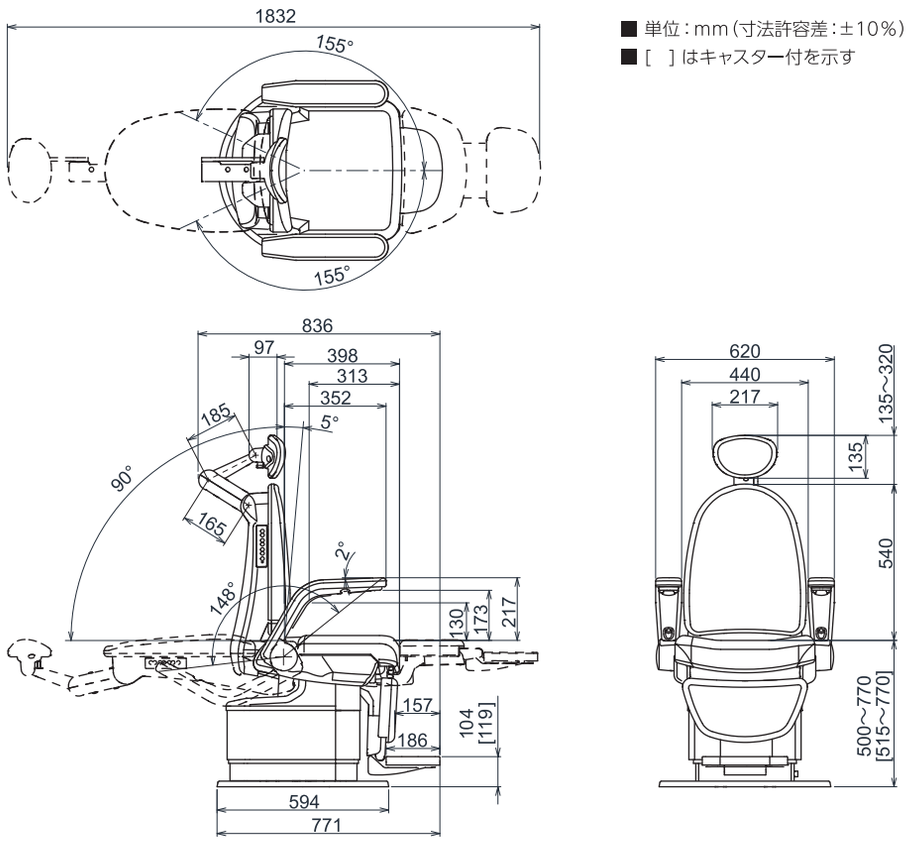

■ 単位：mm（寸法許容差：±10％）
■ [　] はキャスター付を示す

仕　様

	キャスター付	キャスター無
昇降動作	電動油圧式	
ストローク	255 ㎜	270 ㎜
シート高さ(最低位)	515 ㎜	500 ㎜
シート高さ(最高位)	770 ㎜	770 ㎜
リクライニング動作	電動油圧式	
範　囲	0°（水平）～95°	
回転動作	手動式	
ブレーキ	油圧ロック式	
範　囲	310°（原点から左右 155°）	
支頭器の種類	電動２関節支頭器	
メモリー機能	1 パターン（Pボタン）	
ポジションオートリターン機能	原点復帰式（Rボタン）	
キャスター	電動格納式	ー
寸　法	620×771×1630 ㎜	
ベース直径	φ594 ㎜	
リクライニング水平時	1832 ㎜	
質　量	145 kg	130 kg
電気的定格	定格電源　AC100V　50/60Hz 電源入力　430/520VA	

機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラスIのME機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B 形装着部をもつ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX1(フットスイッチ部)
作動(運転)モード	間欠作動(運転)機器

販売名	耳鼻科用診療椅子 Bellety
一般的名称	診療・処置用椅子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器　該当の有無	非該当
設置管理医療機器　該当の有無	非該当
製造販売届出番号	27B1X00042001041

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。

永島医科器械株式会社
SINCE 1910
URL https://www.nagashima-medical.co.jp
[本　　社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1　TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3812-1323
[東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4　TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3816-2824
[名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F　TEL(052)331-3325　FAX(052)331-3326
[大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-315　TEL(06)6484-6123　FAX(06)6484-6122
[九州営業所]〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区 1-2-39-802 TEL(093)342-8526　FAX(093)342-8527

(製造販売元)
タカラベルモント株式会社
大阪本社（本店）
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
TEL:06-6211-2831
東京本社
〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19
TEL:03-3403-0311

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2503-01-K04